


保管用

THRIVE

保証書付

# フットマッサージャー MD-8775

## 取扱説明書

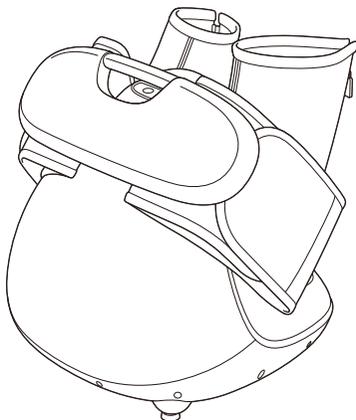

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### 使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用すること

### もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5
- ご使用の前に……………6
- 使いかた……………7・8
- 使用例……………9
- 使用上のご注意……………9
- お手入れについて……………10
- 保管について……………10
- 故障かなと思ったら……………10
- 愛情点検について……………11
- 仕様……………11
- アフターサービスについて…12・13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



## 注意

人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容

### 絵表示の例



○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。



## 警告



禁止

次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。  
(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させる原因になります。

足のマッサージ以外の目的には使用しない。頭、首、胸、腹、骨部へは使用しない。  
事故やけがの原因になります。

ヒーターで足先が熱くなるため、湿度や傷みの感覚が弱い人や自らの意志で  
施術部を動かさない人は使用しない。  
低温やけどの原因になります。

強く押しつけて使用しない。  
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。  
事故やけがの原因になります。



禁止

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。  
事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。  
事故やけがの原因になります。

キャスター付きの椅子に座って使用しない。  
転倒による事故やけがの原因になります。

太もも用エアバッグをきつく巻き過ぎない。  
過度な加圧により太ももを痛める原因になります。

使用中は立ち上がらない。エアバッグに足を入れたまま移動しない。  
転倒による事故やけが、故障の原因になります。

本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。  
感電やショート、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは  
使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店  
またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。  
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。  
また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。  
感電や火災の原因になります。



分解禁止

機器が故障および破損した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様  
ご相談センターに連絡する。電源コードが破損した場合は危険ですので電源コード  
の交換はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。  
機器は改造しない。  
火災や感電、けがの原因になります。



強制

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。  
●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人  
●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人  
●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人  
●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人  
●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、寒寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)  
●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人  
●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人  
●温度感覚喪失が認められる人 ●低温やけどをしたことがある人  
●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人  
事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず機器が破損していないか確認する。  
どんなに小さな破損でもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。  
けがや感電の原因になります。

# 安全上のご注意



 強制	交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。
	電源プラグを定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。

## ⚠ 注意

 禁止	次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこす原因になります。
	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。
	肌の弱い人は素肌で使用しない。 けがややけどの原因になります。
	フトンや毛布をかぶせたり、コタツの中に入れて使用しない。 発火や故障の原因になります。
	ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。
	施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 エアバッグに接触して事故やけが、故障の原因になります。
	本品を移動させる際は、太もも用エアバッグを持って移動しない。 また、太もも用エアバッグを無理に引っ張らない。 エアホースが破損する原因になります。
	落としたり、強い衝撃をあたえない。 事故やけが、故障の原因になります。
	二人以上で同時に使用しない。 事故やけが、故障の原因になります。
	使用中に電源プラグを抜かない。 けがの原因になります。
	水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。 変色、変形の原因になります。	

 水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。
	はじめはマッサージの動きを確認してから、短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。
	使用前に必ずエアバッグの中に異物がないことを確認する。 事故やけがの原因になります。
	エアバッグのファスナーは途中で止めずに必ず一番上まで引き上げた状態で使用する。また、ファスナーは無理やり引き上げない。 ファスナーが破損する原因になります。
	エアホースがねじれた状態で使用しない。 太もも用エアバッグにエアが送り込まれなかったり、操作ボタンが押せなくなる原因になります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。
	使用後は停止ボタンで動作を止め、電源プラグをコンセントから抜き、子供の手の届かないところに保管する。 本品で遊ぶことがないように子供を監視する。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。
電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないように必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートの原因になります。	
故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。	
使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。	
 電源プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でプラグにふれない。 感電ややけどの原因になります。
	停電のときは電源プラグをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。



## 各部の名称

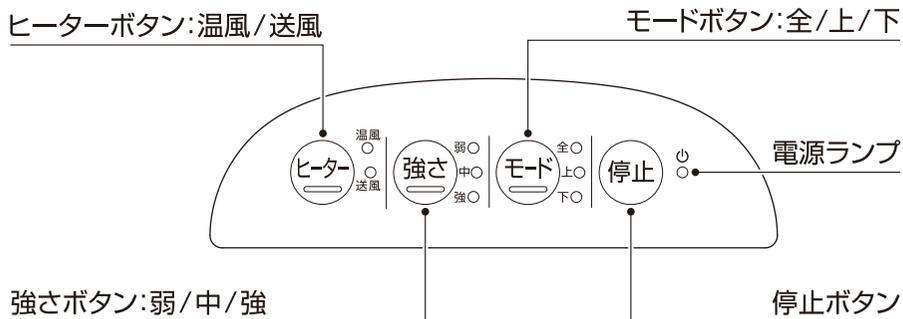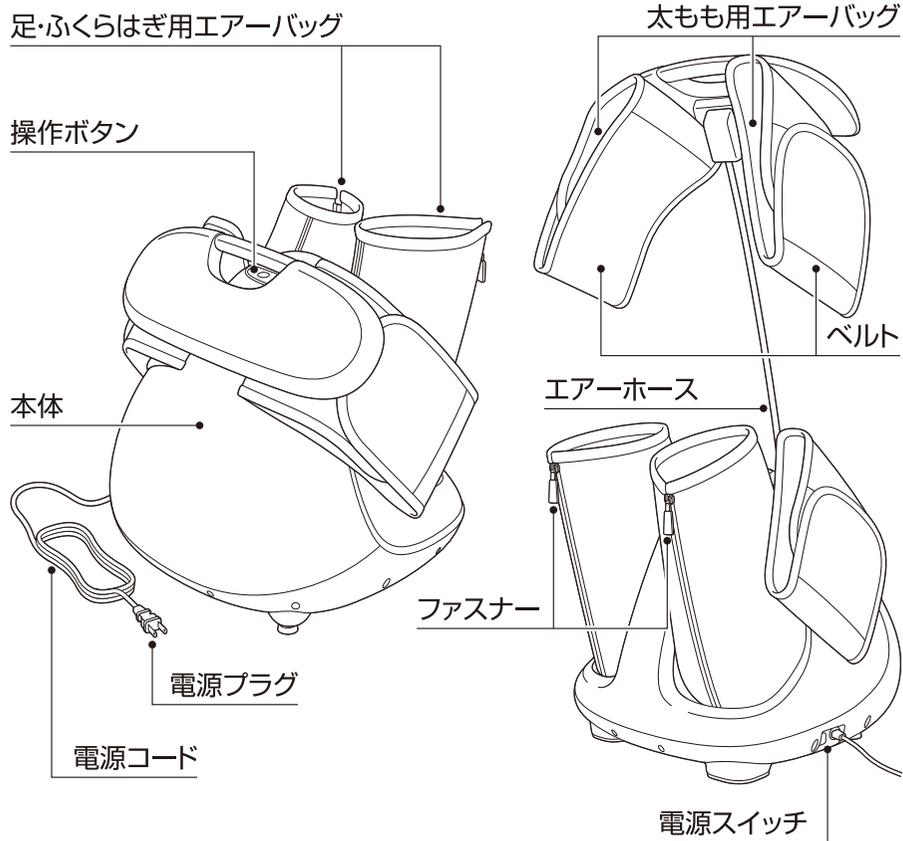

## ご使用の前に

使用前に必ずエアバッグの張地が破れていないか確認し、破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- エアバッグの張地を外した状態や破れた状態で使用しないでください。破れた場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、首、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 本品を移動させる際は、太もも用エアバッグを持って移動しないでください。また、太もも用エアバッグを無理に引っ張らないでください。エアークースが破損する原因になります。
- キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。
- 使用中の動作音をやわらげるとともに床を傷つけないためにマットなどを敷くことをおすすめします。
- 電源プラグをコンセントに差しください。(電源プラグが抜け落ちないように確実に接続する)
- 本体側面下にある電源スイッチを「ON」にしてください。電源ランプが点灯します。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- エアークースがねじれていないかを確認してください。(エアークースにある突起線が真っすぐになっているかを確認する)
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。

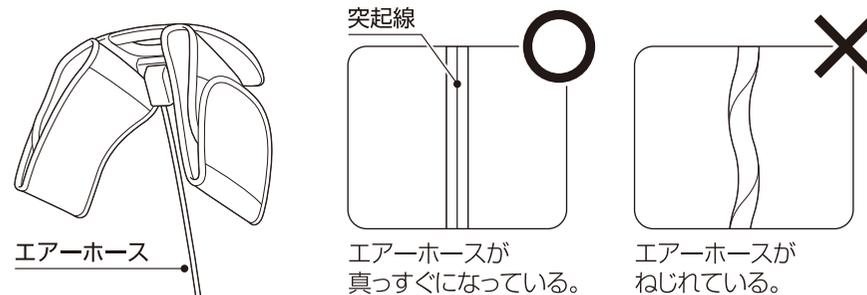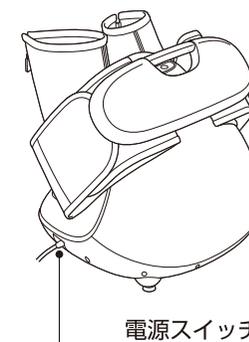

# 使いかた

## 足、ふくらはぎ用エアバッグに脚を入れる。

1. 足・ふくらはぎ用エアバッグのファスナーを一番下まで下げてください。
  2. 両足を入れてください。
  3. 足・ふくらはぎ用エアバッグのファスナーを途中で止めずに必ず一番上まで引き上げてください。
- ファスナーは無理やり引き上げないでください。  
ファスナーが破損する原因になります。
  - 衣服を挟まないように注意してください。



## 太もも用エアバッグを太ももにセットする。

1. 太もも用エアバッグを引き上げてください。  
このとき、エアホースをねじらないように注意してください。
  2. 太もも用エアバッグの面ファスナーを左右ともはがし、太もも用エアバッグを太ももに乗せてください。
  3. 太もも用エアバッグの下側を巻きつけて、面ファスナーで左右とも固定してください。  
このとき、衣服を面ファスナーに接触させないように注意してください。  
また面ファスナーがはずれることを防ぐため、ベルトの先はケースの下に入れてください。
- 太もも用エアバッグを使用しないときは、本体に確実にセットしてください。




- 太もも用エアバッグは加圧時にエアバッグが大きく膨らみます。  
きつい場合は面ファスナーで調節してください。
- 太ももの細い人がベルトをきつく巻くと、面ファスナー同士が合わずに、外れる原因になります。

1. **モード** ボタンを押すと動作を開始します。

ボタンを押すごとに3種類のモードが[全]→[上]→[下]の順番に切り替わり、各エアバッグが動作します。

- [全] ————— 足先、足首、ふくらはぎ、太ももが複合動作しながらマッサージを行います。
- [上] ————— ふくらはぎを中心としたマッサージを行います。
- [下] ————— 足先、足首を中心としたマッサージを行います。



- 太もも用エアバッグを使用しない場合は本体にセットしてください。  
その場合、太もも用エアバッグは動作しません。

1. **強さ** ボタンを押すごとにエアバッグの強さが[弱]から[中][強]の順番に切り替わります。

動作開始時は[弱]に設定されていますので、お好みで選択してください。

1. **ヒーター** ボタンを押すごとに[温風][送風][停止]の順番に切り替わります。

停止の際はしばらくの間、冷却動作を行い、冷却中はランプが点滅することがあります。

2. マッサージを終了したいときは**停止** ボタンを押してください。

3. 電源スイッチを「OFF」にしてください。電源ランプが消灯します。

4. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

5. 面ファスナーは貼り合わせた状態に戻してください。  
太もも用エアバッグを本体に戻してください。



- 移動させる際は、太もも用エアバッグを持って移動しないでください。

## オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。



## 使用例

### ● 太もも用エアースタックあり

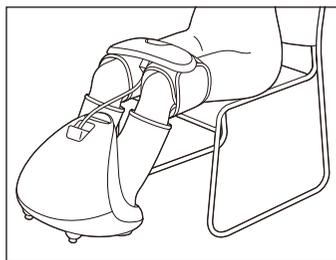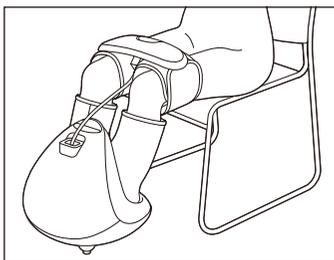

傾けて使用

### ● 太もも用エアースタックなし

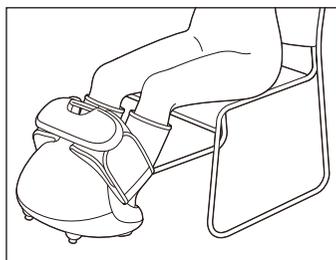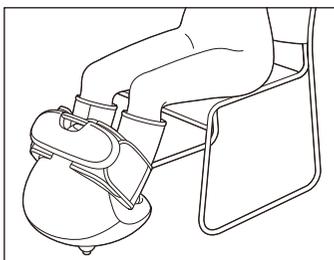

傾けて使用



### 警告

1回の使用時間は10分以内にする。  
1日の使用時間は30分以内にする。  
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

## 使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を付着させないでください。  
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。  
生地の変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。  
生地の変色する原因になります。

## お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。

シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しないでください。  
変色、変形の原因になります。

## 保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどこいて保管してください。

## 故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
● マッサージ中の音 加圧および減圧の音 張地のすれる音(バリバリ音)	● 構造上発生するもので機能に影響はありません
● 動作しない	● 電源プラグが抜けていませんか ● 電源スイッチが「OFF」になっていませんか ● オートタイマーが動き停止状態になっていませんか
● 太もも用エアースタックが動作しない	● エアースタックがねじれていませんか
● ヒーターボタン「温風」を押しても すぐに温まらない	● 温まるまで少し時間がかかりますが 異常ではありません
● ヒーターボタン「温風」を切っても すぐに冷えない	● 自然に冷却させるため少し時間がかかります

症 状	直し方
● 連続使用中にマッサージが止まる	● モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を 確認してください
● 太もも用エアースタックを使用し ていないのにエアースタックが膨らむ	● 太もも用エアースタックを本体にしっかりとセットして ください。

機器に異常音や動作しないなどの異状や故障が発見された場合は使用をただちに中止し、  
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点  
検、修理を依頼してください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● こげくさいにおいがする</li><li>● 電源コード、プラグが異常に熱い</li><li>● コードを動かすと通電したりしなかったりする</li><li>● その他異常がある</li></ul>		<p>故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。</p>
---	---	---	---

## 仕様

販売名	フットマッサージャー MD-8775
医療機器認証番号	304AHBZX00012000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 30W(電熱装置10Wを含む)
定格時間	20分
エア圧力	60kPa以下
オートタイマー	約10分
外形寸法	幅 約42cm×奥行 約42cm×高さ 約43cm
質量	約5.3kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂/ポリエステル エアバッグ:ポリエステル、ナイロン/ポリウレタン
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
(ただし、縫製部品は除きます。)  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

**地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしたがってください。**

# お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  0120-064-762

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、IP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】

都合によりお休みさせていただくことがあります。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

## 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P13のお客様ご相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障および損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ト) 指定外電源（電圧・周波数）使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP12をご覧ください。

**THRIVE**

スライヴ

# 保証書

持込修理

## フットマッサージャー MD-8775

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、製品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P14の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38